



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS – MG

CNPJ: 18.188.235/0001-14

RUA PROFESSORA ROSINA MAGALHÃES FERREIRA, 134.

CEP 37478-000 – SOLEDADE DE MINAS – MG

FONE: (35) 3333-1100 – FAX (35) 3333-1101 – e-mail: licitacao@soledadedeminas.mg.gov.br

EDITAL 24/2025

PROCESSO Nº 55/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025

1ª EMENDA MODIFICATIVA

CONSIDERANDO que posterior publicado o presente certame e mediante impugnações recebidas das empresas APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS LTDA e CMOS DRAKE S/A, sobre o descritivo do item 11 “desfibrilador externo automático”, se constatou que por falha formal e sem má-fé, restou direcionado à marca Toth, especificamente o modelo easyschock, ao mencionar “software Easy Shock Data”, o que é vedado na Lei Federal nº 14.133/2021,

CONSIDERANDO que os atos administrativos podem e devem ser corrigidos a quaisquer tempo, em observância ao Princípio Constitucional da Autotutela Administrativa;

CONSIDERANDO que os atos praticados foram de boa fé e que não acarretam nenhum prejuízo ao erário público, quando o certame ainda encontra-se em fase de divulgação;

CONSIDERANDO os consagrados princípios constitucionais que regem a administração pública e o inteiro teor da Lei Federal de nº 14.133/2021.

RESOLVE O Pregoeiro do Município de Soledade de Minas, em SUSPENDER o Processo de licitação de nº 55/2025, Modalidade Pregão Eletrônico de nº 14/2025, para readequações administrativas em seu edital no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 4 - DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO – ITEM 11 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, cujo descritivo do referido item do edital passará a constar com a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:

Desfibrilador externo automático: armazena os dados do paciente em um cartão interno de 4gb, expansível até 8gb. Também é possível a exportação dos dados por meio de porta usb para visualização em um pc com o software de transferência e gerenciamento de dados. Indicadores de prontidão de uso - 1 x led vermelho e 1 x led verde. Indicador de bateria - bargraph 5 leds. Indicadores modo automático - 3 x leds (preparando, analisando, rcp). Botões - botão liga/desliga | botão entrega de choque | botão paciente pediátrico. Alto-falante - mensagens de instrução, tons de alerta, metrônomo rcp (100 batidas/min). Registro e visualização de eventos - sdcard de 4gb, expansível até 8gb, registro de atendimentos (eventos e curva), registro de autotestes (visualização software pc easyschockdata). Bateria recarregável: tipo - íons de lítio (lithium); capacidade - 14.8v 2600mah; tempo de carga - 1 hora para 70% ou 2 horas para carga completa. Autonomia - 250 choques. Desfibrilação: forma de onda - unid 1 exponencial bifásica truncada. protocolo de rcp configurável - para ajustar de acordo com as diretrizes da instituição ou guidelines aha/erc. Níveis de seleção de energia disponíveis. Modo avançado adulto - 1j; 2j; 3j; 4j; 5j; 6j; 7j; 8j; 9j; 10j; 20j; 30j; 50j; 70j; 100j; 150j; 170j; 200j. Modo avançado pediátrico - 1j; 2j; 3j; 4j; 5j; 6j; 7j; 8j; 9j; 10j; 20j; 30j; 50j; 70j; 100j; 130j; 150j; 170j; 200j. Modo avançado pediátrico - 1j; 2j; 3j; 4j; 5j; 6j; 7j; 8j; 9j; 10j; 20j; 30j; 50j; 70j; 100j. Modo automático/configurável - 30j; 50j;

70j; 100j; 130j; 150j; 170; 200j. Ação: carregar energia. tempo (para 150j) - ? 4 segundos. Tempo (para 200j) - ? 6 segundos.

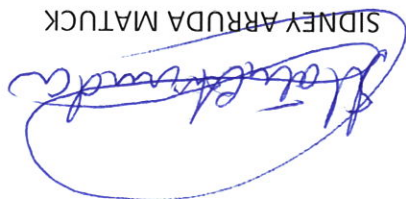
LEIA-SE:

Desfibrilador externo automático, com autonomia da bateria, auxílio RCP, 50 a 250 choques, com 1 par de eletrodo, que atenda as normas técnicas dos órgãos reguladores.

Diante das readaptações necessárias, fica desde já designado o dia **04.08.2025**, às **12:00h** para nova sessão e prosseguimento do processo.

Publique-se.

Soledade de Minas, 08 de julho de 2025.


SIDNEY ARRUDA MATUCK
PREGOEIRO